

Upute za upotrebu

RadiForce® RX250

LCD monitor u boji

Važno

Pročitajte pažljivo ove „Upute za upotrebu” i Priručnik za instalaciju (zasebno) kako bi se upoznali sa sigurnom i učinkovitom upotrebom.

-
- Za prilagodbu i postavke monitora pogledajte Priručnik za instalaciju.
 - Najnovije „Upute za upotrebu” dostupne su za preuzimanje na našem web-mjestu:
<http://www.eizoglobal.com>
-



SIGURNOSNI SIMBOLI

U ovom se priručniku i proizvodu koriste ispod navedeni sigurnosni simboli. Oni ukazuju na važne informacije. Pažljivo ih pročitajte.

UPOZORENJE	OPREZ
 Nepridržavanje informacija označenih kao UPOZORENJE može imati za posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.	 Nepridržavanje informacija označenih kao OPREZ može imati za posljedicu ozbiljne ozljede i ugroziti život.
 Ukazuje da je potrebno obratiti pozornost. Primjerice, simbol  prikazuje vrstu opasnosti kao što je „rizik od strujnog udara”.	
 Ukazuje na zabranjenu radnju. Primjerice, simbol  prikazuje posebno zabranjenu radnju kao što je „Zabranjeno rastavljanje”.	
 Ukazuje na obveznu radnju koja se mora poštivati. Primjerice, simbol  prikazuje obavijest o općoj zabrani kao što je „Uzemljenje jedinice”.	

Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u koje je izvorno isporučen. Ako proizvod radi izvan ovog područja možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.

Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, čuvati u sustavu za dohvaćanje podataka ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima, mehaničkim ili drugim, bez prethodnog pisanog odobrenja korporacije EIZO.


Korporacija EIZO nema obvezu čuvanja povjerljivosti bilo kojeg dostavljenog materijala ili informacije, osim ako tako nije dogovoreno pri prijemu takvih informacija od korporacije EIZO. Premda smo poduzeli sve kako bismo osigurali da ovaj priručnik pruža ažurne informacije, napominjemo da se specifikacije monitora tvrtke EIZO mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.

MJERE OPREZA

VAŽNO

- Ovaj je proizvod posebno prilagođen za korištenje na području u koje je izvorno isporučen. Ako se ovaj proizvod koristi izvan područja za koje je isporučen možda neće raditi kako je navedeno u specifikacijama.
- Pažljivo pročitajte ovaj odlomak i izjave koje se odnose na mjere opreza na monitoru radi osobne zaštite i pravilnog održavanje.

Mjesto gdje su navedene Mjere opreza

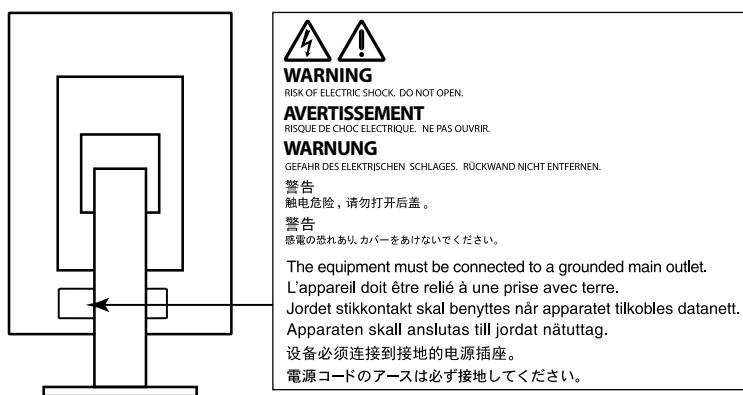

Simboli na jedinici

Simbol	Ovaj simbol označava	
○	Glavna sklopka mrežnog napajanja:	Pritisnite da biste isključili mrežno napajanje monitora.
	Glavna sklopka mrežnog napajanja:	Pritisnite da biste uključili mrežno napajanje monitora.
⊕	Gumb napajanja:	Pritisnite da biste uključili ili isključili napajanje monitora.
~	Izmjenična struja	
⚡	Upozorava na električnu opasnost	
!	OPREZ:	Pogledajte „SIGURNOSNI SIMBOLI“ (stranica 2).
☒	WEEE oznaka:	Proizvod se mora odložiti odvojeno; materijali se mogu reciklirati.
CE	CE oznaka:	Oznaka sukladnosti s propisima Direktive Vijeća i/ili Uredbe (EU).
🏭	Proizvođač	
🖨️	Datum proizvodnje	
EU Medical Device	Medicinski uređaj u EU	
EU Importer	Uvoznik za EU	



UPOZORENJE

Ako se iz jedinice počne širiti dim, ako miriše kao da nešto gori ili ako se čuje čudna buka, odmah isključite sve priključke za napajanje i kontaktirajte s lokalnim zastupnikom tvrtke EIZO. Pokušate li koristiti pokvarenu jedinicu može doći do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.

Nemojte otvarati ormarić ni vršiti preinake na jedinici.

Otvaranje ormarića ili vršenje preinaka na jedinici može dovesti do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.



Prepuštite svako servisiranje kvalificiranom servisnom osoblju.

Nemojte pokušavati sami servisirati proizvod jer otvaranje ili uklanjanje poklopaca može dovesti do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.

Držite sitne predmete ili tekućinu dalje od jedinice.

Sitni predmeti mogu slučajno upasti kroz ventilacijske otvore u ormarić, a prolijevanje tekućine u ormarić može za posljedicu imati požar, električni udar ili oštećenje opreme.



Ako neki predmet upadne u ormarić/izlije se tekućina, odmah isključite jedinicu. Prije ponovnog korištenja jedinicu treba provjeriti kvalificirani servisni inženjer.

Postavite jedinicu na čvrsto i stabilno mjesto.

Jedinica koja nije na odgovarajućoj podlozi može pasti što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

Ako jedinica padne, odmah isključite struju i potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Oštećenu jedinicu nemojte nastaviti koristiti. Korištenje oštećene jedinice može dovesti do požara ili strujnog udara.

Koristite jedinicu na odgovarajućem mjestu.

U suprotnom može doći do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.

- Jedinicu nemojte držati vani.
- Jedinicu nemojte držati u prijevoznim sredstvima (brodovima, zrakoplovima, vlakovima, automobilima i slično).
- Jedinicu nemojte držati u prašnjavoj ili vlažnoj okolini.
- Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje voda može poprskati zaslon (kupaonica, kuhinja i slično).
- Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje para dolazi u izravan doticaj sa zaslonom.
- Jedinicu nemojte držati u blizini uređaja koji proizvode toplinu ni u blizini ovlaživača zraka.
- Jedinicu nemojte držati na mjestima gdje je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Jedinicu nemojte držati u okolini sa zapaljivim plinovima.
- Proizvod nemojte stavlјati u okoline s korozivnim plinovima (kao što je sumporov dioksid, sumporovodik, dušikov dioksid, klor, amonijak i ozon).
- Proizvod nemojte stavlјati u okoline s prašinom, komponentama koje ubrzavaju koroziju u atmosferi (kao što su natrijev klorid i sumpor), vodljivim metalima i sličnim.



Da biste izbjegli opasnost od gušenja držite plastične vrećice za pakiranje izvan dohvata beba i djece.


Koristite priloženi kabel napajanja i spojite ga u standardnu strujnu utičnicu u vašoj zemlji.

Pridržavajte se nazivnog napona kabela napajanja. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.

Napajanje: 100–240 Vac 50/60 Hz

Da biste odspojili kabel napajanja čvrsto uhvatite utikač i povucite.

Potezanje kabela može dovesti do požara ili strujnog udara.



Oprema mora biti spojena s uzemljom mrežnom utičnicom.

U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.





UPOZORENJE

Koristite ispravan napon.

- Jedinica je namijenjena za upotrebu isključivo pri određenom naponu. Spajanje na napon različit od onog navedenom u ovim „Uputama za upotrebu“ može prouzročiti požar, strujni udar i oštećenje opreme.
Napajanje: 100–240 Vac 50/60 Hz
- Nemojte preopterećivati strujni krug jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.



Kabelom napajanja rukujte pažljivo.

- Ne postavljanje kabel ispod jedinice ili drugih teških predmeta.
- Nemojte vući ili vezati kabel.

Ako se kabel ošteti, prestanite ga koristiti. Korištenje oštećenog kabla može dovesti do požara ili strujnog udara.



Radi električne sigurnosti nemojte spajati ili odspajati kabel napajanja u prisutnosti pacijenata.

Nikada nemojte dodirivati utikač i kabel napajanja ako počne grmjeti.

Dodirivanje može dovesti do strujnog udara.

Pri pričvršćivanju stalka s krakom pridržavajte se korisničkog priručnika za stalak s krakom i instalirajte jedinicu na siguran način.

U protivnom može doći do odvajanja jedinice što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme. Prije instalacije provjerite mehaničku čvrstoću stolova, zidova i drugih predmeta na koje će stalak s krakom biti pričvršćen. Ako jedinica padne, potražite savjet od lokalnog predstavnika tvrtke EIZO. Oštećenu jedinicu nemojte nastaviti koristiti. Korištenje oštećene jedinice može dovesti do požara ili strujnog udara. Pri ponovnom pričvršćivanju stalaka s nagibom koristite iste vijke i čvrsto ih zategnite.



Oštećenu LCD ploču nemojte dirati golim rukama.

Tekući kristali, koji mogu iscuriti iz ploče, otrovni su ako dospiju u oči ili usta. Ako bilo koji dio vaše kože ili tijela bude u izravnom dodiru s pločom, dobro ga isperite. Ako primijetite neki od tjelesnih simptoma, obratite se svom liječniku.



Fluorescentne pozadinske žaruljice sadrže živu (proizvodi s pozadinskim LED žaruljcama ne sadrže živu), odlažite ih u skladu s lokalnim, državnim ili federalnim zakonima.

Izlaganje elementarnoj živi može imati učinke na živčani sustav, uključujući drhtavicu, gubitak pamćenja i glavobolje.

OPREZ

Jedinicu pažljivo prenosite.


Pri premještanju jedinice odspojite kabel napajanja i druge kabele. Premještanje jedinice s uključenim kabelom napajanje je opasno.

Može doći do ozljede.

Jedinicu nosite ili je postavite u skladu s navedenim ispravnim načinima.

- Jedinicu pri prenošenju uhvatite čvrsto i držite kako je prikazano na slici ispod.
- Monitori veličine 30 inča i više su teški. Prilikom raspakiravanja i/ili prijenosa monitora, pobrinite se da budu uključene barem 2 osobe.

Ispuštanje jedinice može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.

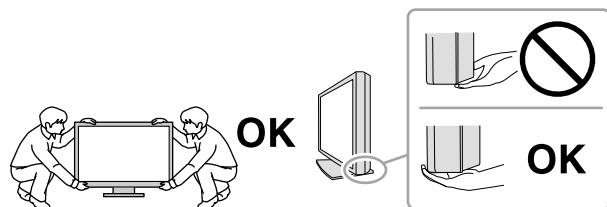

Nemojte zaklanjati ventilacijske otvore na ormariću.

- Na ventilacijske otvore ne postavljajte nikakve predmete.
- Jedinicu nemojte instalirati u zatvorenom prostoru.
- Jedinicu nemojte koristiti položenu ili okrenutu naopako.

Zaklanjanje ventilacijskih otvora sprječava pravilan protok zraka i može dovesti do požara, strujnog udara i oštećenja opreme.



Utikač nemojte dodirivati vlažnim rukama.

Inače može doći do strujnog udara.



Koristite pristupačnu strujnu utičnicu.

Time ćete osigurati brzo isključivanje napajanja u slučaju poteškoća.

Redovito čistite područje oko utikača i ventilacijskog otvora monitora.

Prašina, voda ili ulje na utikaču mogu dovesti do požara.

Prije čišćenja isključite jedinicu iz struje.

Čišćenje jedinice dok je priključena u strujnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.

Ako jedinicu ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, nakon isključivanja sklopke napajanja isključite kabel napajanja iz zidne utičnice radi sigurnosti i uštede energije.

Ovaj je proizvod prikladan za korištenje u blizini pacijenta, ali ne i da bude u doticaju s pacijentom.

Za korisnike na području EGP-a i Švicarske:

Svaki ozbiljan štetni događaj do kojeg je došlo u vezi s uređajem treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalaze korisnik i/ili pacijent.

Obavijesti uz ovaj monitor

Predviđena namjena


Predviđena namjena ovog proizvoda jest prikazivanje i pregledavanje digitalnih slika namijenjenih pregledu, analizi i dijagnozi ospozobljenih medicinskih stručnjaka. Prikaz nije namijenjen za mamografiju.

Pažnja

- Proizvod možda neće imati važeće jamstvo za bilo koje druge upotrebe osim onih opisanih u ovom priručniku.
- Specifikacije navedene u ovom priručniku primjenjuju se samo kada se koristi sljedeće:
 - kabel napajanja isporučen uz proizvod
 - naznačeni signalni kabeli
- Uz ovaj proizvod koristite samo one dodatne proizvod koje smo mi naveli.

Instalacijski uvjeti

- Pažljivo pročitajte „[MJERE OPREZA](#)“ ([stranica 3](#)) i uvijek slijedite upute.
- Ako monitor montirate na stalak, osigurajte dovoljno prostora na bočnim stranama te iznad i iza monitora.

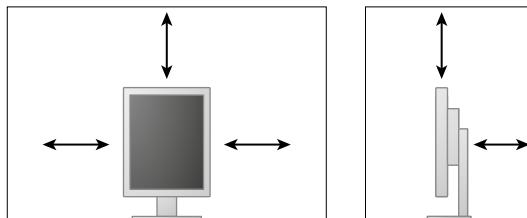

- Postavite monitor tako da nikakvo svjetlo ne ometa prikaz na zaslonu.
- Ako ovaj proizvod smjestite na lakirani stol, boja može prianjati za dno postolja zbog sastava gume. Prije upotrebe provjerite površinu stola.

Održavanje

- Na kvalitetu zaslona monitora utječe razina kvalitete ulaznih signala i degradacija proizvoda. Preporučuju se dnevne provjere i test periodične konstantnosti kako bi se bilo sukladno s medicinskim standardima/smjernicama prema vašoj aplikaciji. Upotreba softvera kontrole kvalitete monitora RadiCS omogućava vam provedbu ukupne kontrole kvalitete na visokoj razini koja ispunjava medicinske standarde/smjernice.
- Potrebno je oko 15 minuta da se stabilizira rad električnih dijelova. Nakon uključivanja monitora ili ponovnog aktiviranja monitora iz načina rada za uštedu energije pričekajte 15 minuta ili dulje pa tek onda prilagođavajte monitor.
- Monitore treba namjestiti na nižu svjetlinu da bi se smanjile promjene u osvjetljenju koje prouzrokuje dugoročna uporaba i zadržala stabilnost prikaza. Redovito provodite ispitivanje stabilnosti. Kalibraciju provodite po potrebi. Pojedinosti potražite u Korisničkom priručniku softvera za kontrolu kvalitete monitora RadiCS/RadiCS LE.
- Za održavanje točnosti mjerenja integriranog prednjeg senzora, provedite periodičku korelaciju uporabom RadiCS/RadiCS LE.
- Dijelovi (poput LCD panela) mogu se pokvariti uslijed dugotrajne uporabe. Redovito provjeravajte da normalno funkcioniraju.
- Kad se slika na zaslon promijeni nakon što je dulje vremena bila prikazana ista slike može se pojaviti pozadinska slike. Koristite čuvar zaslona ili funkciju uštede energije da biste izbjegli prikazivanje iste slike tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
- Ako monitor radi neprekidno ili tijekom dugog razdoblja, mogu se pojaviti tamne mrlje ili se slika može trajno zadržati. Da biste maksimalno produljili vijek trajanja monitora, preporučujemo da redovito isključujete monitor.
- Pozadinsko svjetlo LCD ploče ima ograničen vijek trajanja. Ako se zaslon zatamni ili počne treperiti, kontaktirajte s lokalnim predstavnikom tvrtke EIZO.
- Na zaslonu se mogu prikazati oštećeni pikseli ili mali broj svijetlih točaka na zaslonu. Razlog tomu su karakteristike same ploče, a ne kvar proizvoda.
- Ploču ili rubove okvira nemojte čvrsto pritiskati jer to može dovesti do neispravnog prikaza, poput uzoraka interferencije itd. Ako se na ploču stalno primjenjuje pritisak, to može dovesti do kvara ili oštećenja ploče. (Ako na ploči ostanu tragovi pritiska, ostavite monitor neko vrijeme s crnim ili bijelim zaslonom. Simptom će možda nestati).
- Ploču nemojte grebatи ni pritiskati oštре predmete uz nju jer to može dovesti do oštećenja ploče. Nemojte brisati ploču papirnatim maramicama jer to može ostaviti ogrebotine na ploči.
- Ako je monitor hladan ili je bio na hladnom pa se unese u sobu ili sobna temperatura naglo poraste, na unutarnjim i vanjskim površinama monitora može se pojaviti kondenzacija. U tom slučaju nemojte uključivati monitor. Pričekajte da kondenzacija nestane jer u protivnom može doći do oštećenja monitora.

Čišćenje

Preporučuje se povremeno čišćenje da bi se održao nov izgled monitora i produljio njegov radni vijek.

Pažnja

- Ne upotrebljavajte često kemijska sredstva. Kemijska sredstva poput alkohola ili antiseptičkih sredstava mogu prouzročiti promjene u sjaju premaza uređaja, gubljenje ili bljeđenje boje ormarića ili ploče, ali i kvarenje slike.
- Za čišćenje nikada nemojte koristiti razrjeđivač, benzen, vosak ili abrazivno sredstvo koji mogu oštetiti ormarić ili ploču.
- Pazite da kemijska sredstva ne dođu u izravan kontakt s monitorom.

Napomena

- Za čišćenje ormarića i ploče preporučuje se ScreenCleaner, koji se kupuje zasebno.

Pažljivo obrišite prašinu s ormara ili ploče mekom krpicom natopljenom malom količinom vode ili jednim od kemijskih sredstava navedenih u nastavku.

Kemijska sredstva koja se mogu upotrebljavati za čišćenje

Naziv materijala	Naziv proizvoda
Etanol	Etanol
Izopropilni alkohol	Izopropilni alkohol
Klorheksidin	Hibitane
Natrijev hipoklorit	Purelox
Benzalkonijev klorid	Welpas
Alkildiaminoetilglicin	Tego 51
Glutaral	Sterihyde
Glutaral	Cidex Plus28

Za ugodno korištenje monitora

- Dugotrajno gledanje u monitor zamara oči. Napravite stanku od 10-ak minuta svakih sat vremena.
- Gledajte u zaslon s odgovarajuće udaljenosti i pod odgovarajućim kutom.

POGLAVLJE

MJERE OPREZA.....	3
VAŽNO	3
Obavijesti uz ovaj monitor	7
POGLAVLJE.....	10
Poglavlje 1 Uvod	11
1-1. Značajke	11
1-2. Sadržaj paketa.....	12
1-3. EIZO LCD Utility Disk.....	12
● Sadržaj diska i pregled softvera	12
● Korištenje softvera RadiCS LE	12
1-4. Kontrole i funkcije.....	13
1-5. Kompatibilne razlučivosti	14
Poglavlje 2 Spajanje	15
2-1. Kabeli za spajanje	15
2-2. Iskorištavanje USB-a (univerzalna serijska sabirnica)	17
● Potrebno okruženje za računalo	17
● Postupak spajanja (podešavanje USB funkcije).....	18
Poglavlje 3 Postavljanje	19
3-1. Prilagodba visine i kuta zaslona	19
3-2. Pričvršćivanje ručice.....	20
Poglavlje 4 Otklanjanje poteškoća	21
Poglavlje 5 Specifikacije	22
5-1. Popis specifikacija.....	22
5-2. Glavne zadane postavke	23
5-3. Dimenzije	24
5-4. Dodatna oprema.....	24
Poglavlje 6 Pojmovnik	25
Dodatak	27
Zaštitni znak	27
Licenca	28
Medicinski standard.....	28
EMK podaci	29

Poglavlje 1 Uvod

Hvala vam što ste odabrali LCD monitor u boji tvrtke EIZO.

1-1. Značajke

- 21,3 inča
- Podržava razlučivost od 2 M piksela (Portret : 1200 × 1600 točaka (H × V))
- Koristi ploču s visokim kontrastom (1400 : 1).
Omogućuje prikaz oštih slika.
- Primjenjiv na DisplayPort (primjenjiv na 8 bita ili 10 bita, nije primjenjiv na audio signale)
- Uključena je funkcija serijskog spajanja koja omogućava da se više monitora spoji kabelom DisplayPort.
Potrebna je grafička ploča koja podržava DisplayPort 1.2. Za pojedinosti proučite web stranicu EIZO.
<http://www.eizoglobal.com>
- Funkcija CAL prekidača omogućuje korisniku da odabere optimalan način prikaza za prikazanu sliku.
Informacije potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Moguć odabir zaslona u skladu sa standardom DICOM ([stranica 25](#)) Dio 14.
- Softver za kontrolu kvalitete „RadiCS LE”, koji se koristi za kalibriranje monitora i upravljanje poviješću je priložen uz uređaj.
Pogledajte „[1-3. EIZO LCD Utility Disk](#)“ ([stranica 12](#)).
- Način rada za uštedu energije
Ovaj proizvod ima funkciju uštede energije.
 - Kad je mrežno napajanje isključeno potrošnja električne energije je 0 W
Uredaj je opremljen mrežnom sklopkom.
Kada ne koristite monitor možete isključiti izbor glavnog napajanja tako da je napajanje u potpunosti presjećeno.
 - Senzor prisutnosti
Senzor na prednjoj strani monitora otkriva kretanje osobe. Kad se osoba udalji od monitora, monitor se prebacuje u način rada za uštedu energije automatski i ne prikazuje slike na zaslonu. Stoga ova funkcija smanjuje potrošnju električne energije.
Informacije potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).
- Niskoprofilni i lagani dizajn
- Pozadinsko osvjetljenje LCD ploče LED žaruljicama dugog vijeka trajanja
- Ugrađeni senzor sobnog osvjetljenja
Ovisno o okruženju u kojem se nalazi, senzor ponekad može prikazivati različite vrijednosti od onih koje mjeri samostalni mjerač osvjetljenja.
Upotreba ovog senzora zahtijeva softver za upravljanje kvalitetom „RadiCS/RadiCS LE“, a mjerjenje se uvijek pokreće korisničkom radnjom u odgovarajućem izborniku.
- Dodatne pojedinosti o izmjeranim vrijednostima i načinu izvršenja mjerjenja potražite u Korisničkom priručniku za softver RadiCS/RadiCS LE (na CD-ROMu).

1-2. Sadržaj paketa


Provjerite sadrži li pakiranje sve sljedeće stavke. Ako bilo koja stavka nedostaje kontaktirajte s lokalnim predstavnikom tvrtke EIZO.

Napomena

- Sačuvajte kutiju pakiranja i materijale u slučaju budućeg premještanja ili prijevoza monitora.


- Monitor

- Kabel napajanja




- Kabel digitalnog signala : PP300

DisplayPort – DisplayPort




- Kabel digitalnog signala : DD300

DVI - DVI (Single Link)



- USB kabel : UU300



- Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO (CD-ROM)

- Upute za upotrebu (ovaj priručnik)

1-3. EIZO LCD Utility Disk

Disk s uslužnim programima za LCD monitor tvrtke EIZO (CD-ROM) isporučuje se uz ovaj proizvod.

Sljedeća tablica prikazuje sadržaj diska i pregled softverskih programa.

● Sadržaj diska i pregled softvera

Na disku se nalazi softver za kontrolu kvalitete i korisnički priručnik. Postupke pokretanja softvera ili postupke pristupa datotekama potražite u datoteci *Readme.txt* na disku.

Sadržaj	Pregled
Datoteka <i>Readme.txt</i>	
RadiCS LE (za operacijski sustav Windows)	Softver za kontrolu kvalitete za kalibriranje monitora i upravljanje poviješću kalibracije.
Priručnik za instalaciju ovog monitora (datoteka u formatu PDF)	
„Upute za upotrebu“ ovog monitora (datoteka u formatu PDF)	

● Korištenje softvera RadiCS LE


Informacije o instalaciji i korištenju softvera "RadiCS LE" potražite u Korisničkom priručniku na disku.

Pri korištenju ovog softvera trebate spojiti osobno računalo s monitorom pomoću priloženog USB kabela (Pogledajte „[2-2. Iskorištavanje USB-a \(univerzalna serijska sabirница\)](#)“ (stranica 17)).

Napomena

- Uporaba DCC komunikacije omogućuje vam da koristite softver RadiCS LE bez potrebe za uporabom USB kabela. Za informacije o tome kako konfigurirati DDC komunikaciju proučite Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

1-4. Kontrole i funkcije

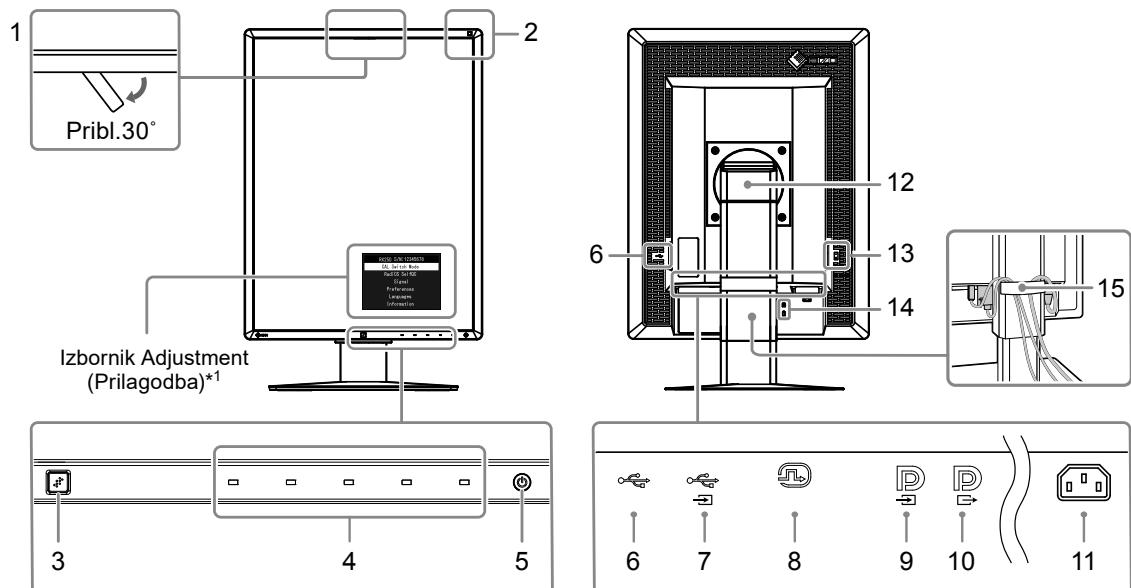

1. Integrirani prednji senzor (Mobilni)	Koristi se za kalibraciju i provjeru sivih tonova.
2. Senzor sobnog svjetla	Mjeri osvjetljenje u okolini.
3. Senzor prisutnosti	Otkriva kretanje osobe ispred monitora.
4. Sklopke rada	Prikazuje izbornik. Slijedite priručnik za izvođenje željenih radnji.
5. Gumb ⏻	<ul style="list-style-type: none"> Uključuje ili isključuje napajanje. Ukazuje na radno stanje monitora. Zelena žaruljica: Uključeno, Narančasta žaruljica: Način rada za uštedu energije, ISKLJUČENO: Mrežno napajanje/isključeno mrežno napajanje
6. Donji ulaz za USB	Spaja periferni USB uređaj.
7. Gornji ulaz za USB	Spaja USB kabel za korištenje softvera koji zahtijeva USB spoj ili za korištenje funkcije USB koncentratora.
8. DVI-D priključnica	Spojite ga s računalom.
9. DisplayPort ulazna priključnica	Spojite ga s računalom. Za podešavanje serijskog spajanja spojite kabel na izlaznu priključnicu uzlaznog monitora.
10. DisplayPort izlazna priključnica	Za podešavanje serijskog spajanja spojite kabel na ulaznu priključnicu silaznog monitora.
11. Priključnica napajanja	Spaja kabel napajanja.
12. Stalak	Upotrebljava se za prilagođavanje visine i kuta zaslona monitora.
13. Glavna sklopka mrežnog napajanja	Uključuje ili isključuje mrežno napajanje. ○ : Isključeno : Uključeno
14. Utvrda za sigurnosnu bravu	U skladu sa sigurnosnim sustavom Kensington's MicroSaver.
15. Držać kabela	Pokriva kablove monitora.

*1 Upute za upotrebu potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u).

1-5. Kompatibilne razlučivosti

Monitor podržava sljedeće razlučivosti.

✓ : Podržano

Razlučivost	frekvencija vertikalnog skeniranja	DisplayPort ^{*1}		DVI	
		Portretno	Pejzažno	Portretno	Pejzažno
720 × 400	70 Hz	✓	✓	✓	✓
640 × 480	60 Hz	✓	✓	✓	✓
800 × 600	60 Hz	✓	✓	✓	✓
1024 × 768	60 Hz	✓	✓	✓	✓
1280 × 1024	60 Hz	-	✓	-	✓
1200 × 1600	60 Hz	✓	-	✓	-
1600 × 1200	60 Hz	-	✓	-	✓

*1 Odgovara i za 10 bita.

Poglavlje 2 Spajanje

2-1. Kabeli za spajanje

Pažnja

- Provjerite jesu li monitor i računalo isključeni.
- Kada zamjenjujete trenutačni monitor s ovim monitorom, pogledajte „[1-5. Kompatibilne razlučivosti](#)“ (stranica 14) monitor s ovim monitorom, obavezno promijenite računalne postavke za razlučivost i frekvenciju vertikalnog skeniranja na one koje su dostupne za ovaj monitor.

1. Okrenite zaslon monitora za 90° u smjeru kazaljke na satu.

Pejzažni položaj zadano je usmjerenje monitora.

Pažnja

- Prije uključivanja zaslona monitora, podignite na najvišu razinu.


2. Spajanje signalnih kabela.

Provjerite oblik priključnica i spojite kabele. Nakon spajanja DVI kabela, zategnite učvršćivače kako bi se osigurali konektor.

Spajanje s jednim računalom


Pažnja

- Priklučci DisplayPort monitora sastoje se od ulaznih i izlaznih . Kada priključujete monitor na računalo, priključite kabel na ulazni priključak .

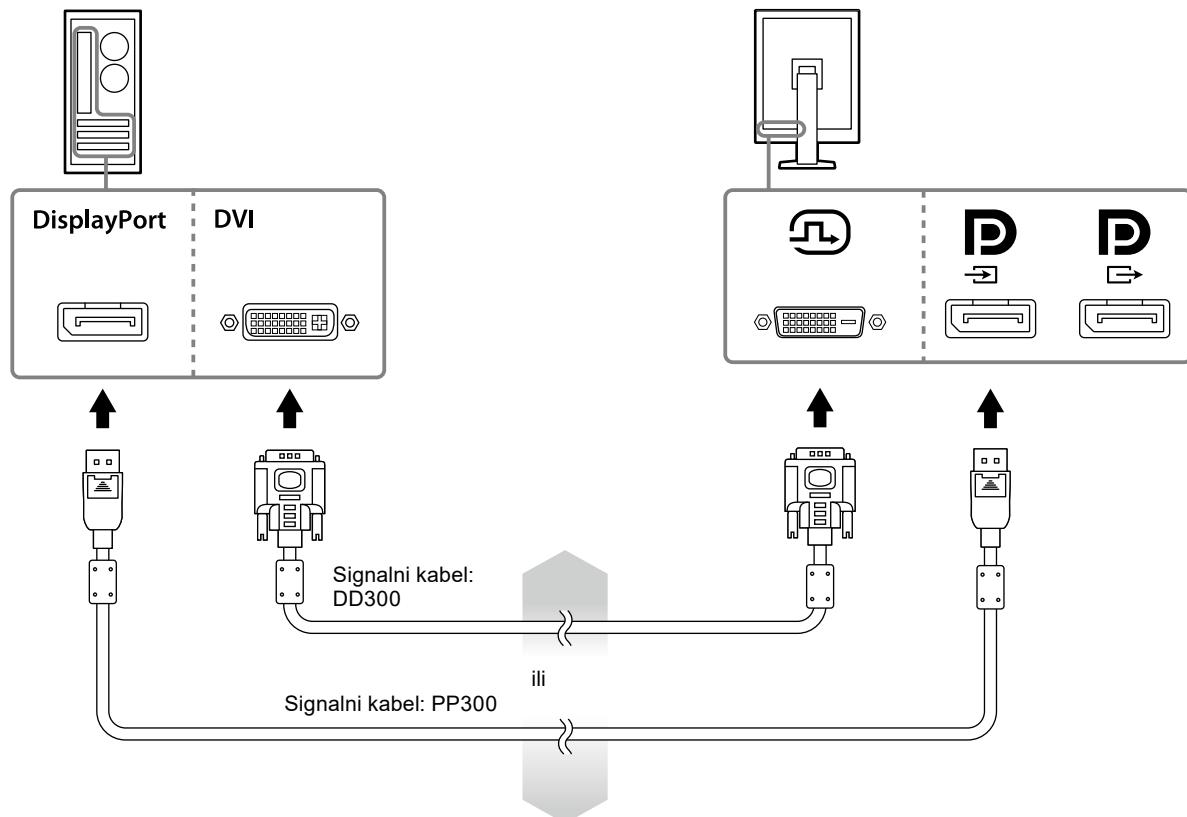

Spajanje s više računala


Za informacije o tome kako prebaciti ulazne signale proučite Priručnik za podešavanje (na CD-ROM-u).

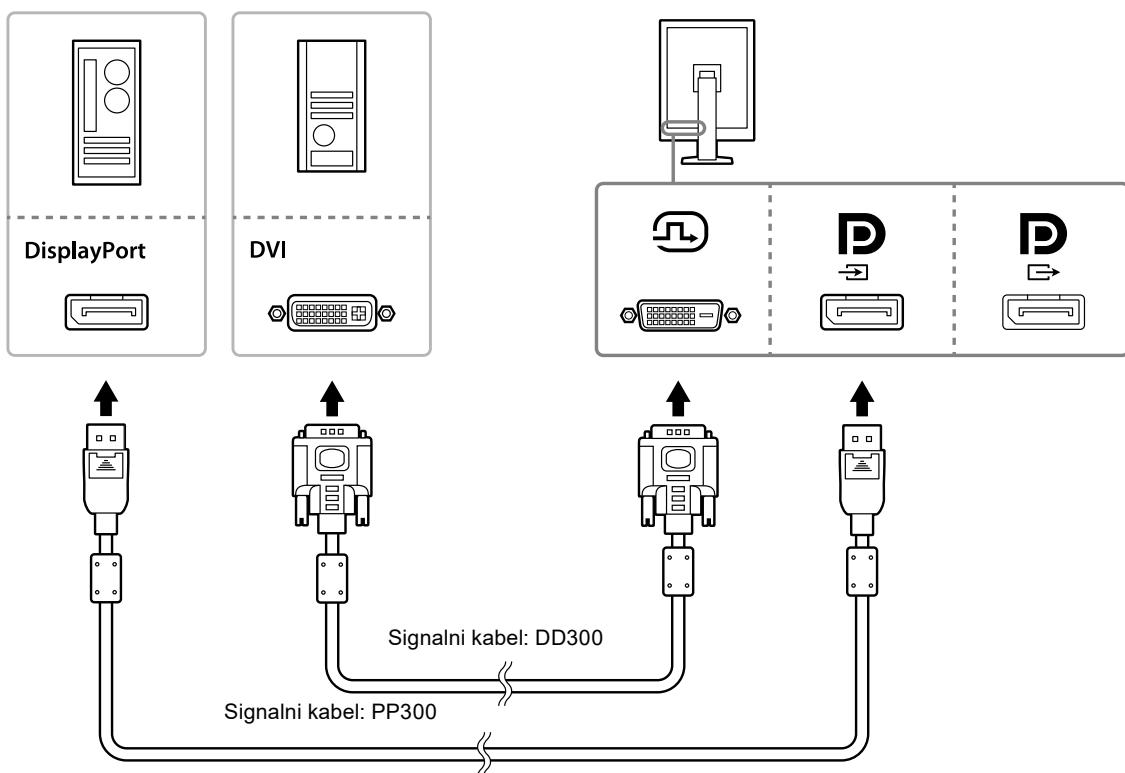

Paralelno spajanje više monitora

Pažnja

- Posjetite web stranicu EIZO za informacije o monitorima i grafičkim pločama koji se može koristiti za serijsko spajanje: <http://www.eizoglobal.com>
- Skinite  kapicu prije spajanja signalnog kabela.

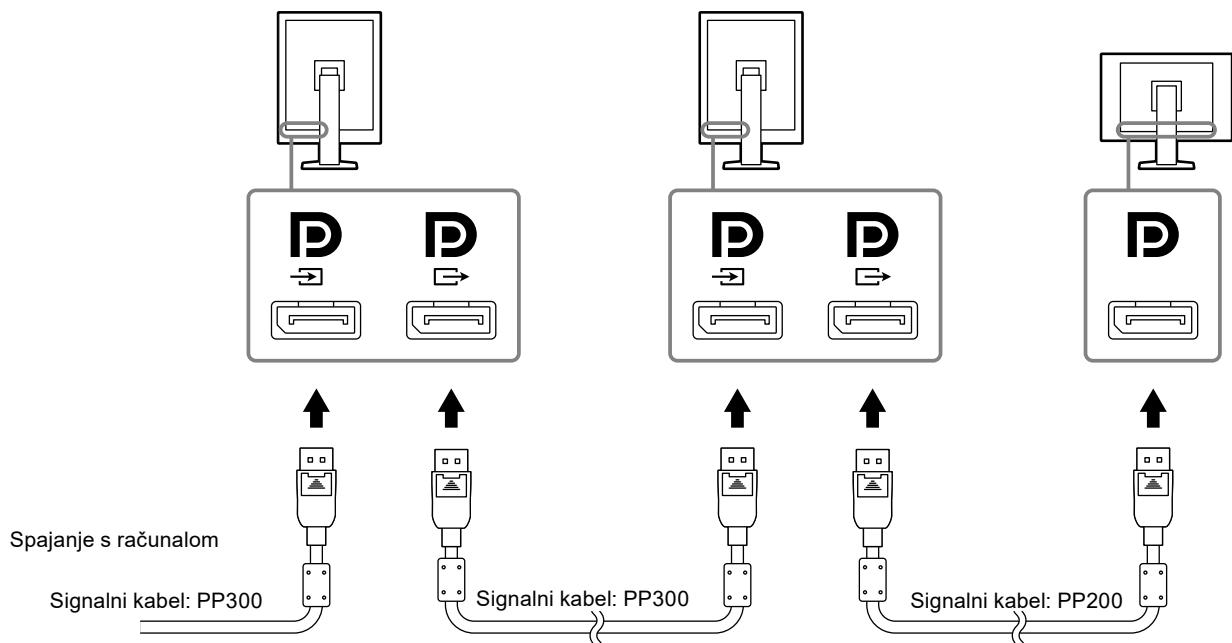

3. Uključite električni kabel u utičnicu i električnu priključnicu na monitoru.

4. Spojite USB kabel dok upotrebljavate RadiCS LE.

Za informacije o spajanju uzlazne USB priključnice, proučite „[2-2. Iskorištavanje USB-a \(univerzalna serijska sabirnica\)](#)“ (stranica 17).



Napomena

- Uporaba DCC komunikacije omogućuje vam da koristite softver RadiCS LE bez potrebe za uporabom USB kabela. Za informacije o tome kako konfigurirati DDC komunikaciju proučite Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).

5. Dodirnite ⚡ za uključivanje napajanja monitora.

Pokazivač napajanja monitora svijetli zeleno.

6. Uključite računalo.

Pojavljuje se slika zaslona.

Ako se slika ne pojavi, pogledajte „[Poglavlje 4 Otklanjanje poteškoća](#)“ (stranica 21) za dodatni savjet.

Pažnja

- Za maksimalnu uštedu energije preporučujemo da gumb napajanja bude isključen. Kada ne koristite monitor možete isključiti izbor glavnog napajanja ili otpojiti utikač za napajanje tako da je napajanje u potpunosti presjećeno.

Napomena

- Kako biste maksimalno povećali vijek trajanja monitora i smanjili pogoršanje svjetline kao i potrošnju energije, učinite sljedeće:
 - Upotrijebite funkciju za uštedu energije na računalu.
 - Isključite monitor i računalo nakon upotrebe.

2-2. Iskorištavanje USB-a (univerzalna serijska sabirnica)

Monitor ima koncentrator kompatibilan s USB-om. Spojen na osobno računalo kompatibilno s USB-om ili drugim USB koncentratorom monitor funkcioniра као USB koncentrator omogućavajući spajanje na periferne USB uređaje.

● Potrebno okruženje za računalo


- Osobno računalo opremljeno USB priključnicom ili drugim USB koncentratorom na USB kompatibilno osobno računalo.
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista/Windows XP ili Mac OS X 10.2 ili noviji
- USB kabel

Pažnja

- Ovaj monitor možda neće raditi ovisno o osobnom računalu, operativnom sustavu ili perifernim uređajima koji će se koristiti. Za USB kompatibilnost perifernih uređaja obratite se njihovim proizvođačima.
- Uređaji spojeni na silazni USB priključak radit će dok je monitor u režimu rada za uštedu energije ili kada se isključi napajanje putem gumba na monitoru. Stoga, potrošnja napona monitora varira sa spojenim uređajima čak i u načinu rada uštede napajanja.
- Kada je isključeno glavno napajanje, uređaj spojen na USB priključnicu neće raditi.

● Postupak spajanja (podešavanje USB funkcije)


1. Spojite prvo monitor na osobno računalo signalnim kabelom i pokrenite osobno računalo.
2. Spojite isporučeni USB kabel između silazne priključnice USB-a na osobno računalo kompatibilno s USB-om (ili drugim USB koncentratorom) i monitorom uzlazne priključnice USB-a.
Funkcija USB koncentratora podešava se automatski nakon spajanja na USB kabel.
3. Spojite periferni USB uređaj na USB silaznu priključnicu monitora.

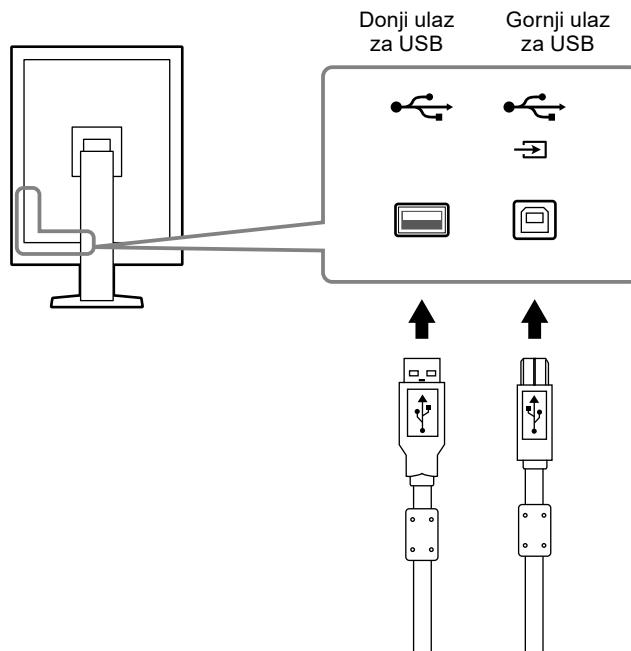

Poglavlje 3 Postavljanje

3-1. Prilagodba visine i kuta zaslona

Držite lijevi i desni rub monitora objema rukama i prilagodite visinu, nagib i zakrenutost zaslona u položaj koji je najbolji za rad.

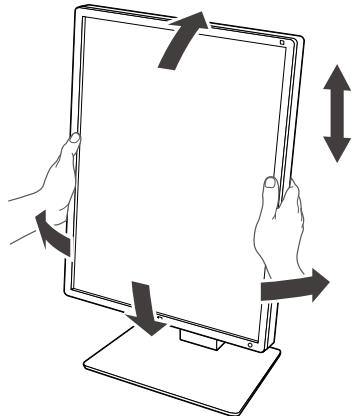

Pažnja

- Nakon što ste obavili prilagodbu, pobrinite seda su kabeli ispravno spojeni i postavite ih kroz držač za kabele.

3-2. Pričvršćivanje ručice

Neobavetna ručica (ili neobavezni stalak) može se pričvrstiti uklanjanjem dijela za stalak. Za podržane neobavezne ručice (ili neobavezne držače), proučite web stranicu EIZO: <http://www.eizoglobal.com>

Pažnja

- Prilikom pričvršćivanja ručice ili stolca, pridržavajte se uputa u njihovom korisničkom priručniku.
- Prilikom uporabe ručice ili stolca drugog proizvođača potvrdite unaprijed sljedeće i odaberite one koji su sukladni sa standardom VESA.
 - Slobodni prostor između otvora za vijke, 100 mm × 100 mm
 - VESA postolje ručice ili stolca, vanjske dimenzije: 122 mm × 122 mm ili manje
 - Dovoljno jaki da podrže težinu jedinice monitora (osim stolca) i dodatke poput kabela.
- Prilikom uporabe ručice ili stolca drugog proizvođača upotrijebite sljedeće vijke da biste ga učvrstili.
 - Vijci fiskiraju stalak na monitor
- Prilikom uporabe ručice ili stolca, pričvrstite ih da ispunе sljedeći zahtjev za nagibom kuta monitora.
 - Gore 45°, dolje 45° (Kada se uporabi portretni prikaz te kada se okreće za 90° suprotno od kazaljke na satu za portretni pejzažni prikaz.)
- Spojite kabele nakon pričvršćivanja ručice ili stolca.
- Nemojte pomicati uklonjeni stalak gore-dolje. Na taj način može doći do ozljede ili oštećenja opreme.
- Monitor i ručica ili stalak su teški. Njihovo ispuštanje može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme.
- Povremeno provjerite jesu li vijci zategnuti. Ako nisu dovoljno zategnuti, monitor se može odvojiti od nosača, što može dovesti do ozljede ili oštećenja opreme

Postupak


1. Položite LCD monitor na mekanu krpu raširenu preko stabilne površine s površinom panela okrenutom prema dolje.

2. Uklonite stalak.

Pripremite odvijač. Olabavite vijke (četiri) koji učvršćuju uređaj i stalak da ga se pričvrsti.


3. Pričvrstite ručicu ili stalak na monitor.

Uporabite vijke koje ste uklonili u koraku 2 kako biste pričvrstili nosač (ili stalak) na monitor.

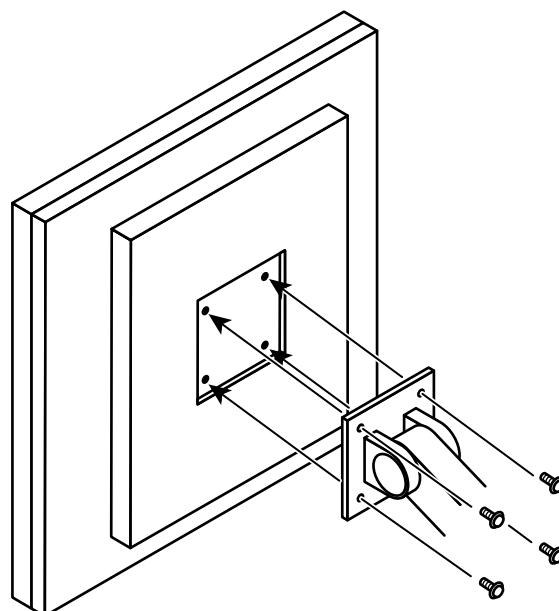

Poglavlje 4 Otklanjanje poteškoća

Ako problem i dalje postoji nakon primjene predloženih rješenja, kontaktirajte lokalnog zastupnika tvrtke EIZO.

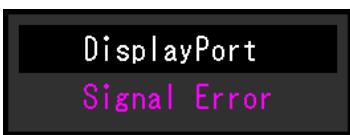Problem	Mogući uzrok i rješenje
1. Nema slike <ul style="list-style-type: none">• Pokazivač napajanja ne svijetli.• Pokazivač napajanja svijetli zeleno.• Pokazivač napajanja svijetli narančasto.• Pokazivač napajanja treperi narančasto i zeleno.	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li električni kabel ispravno spojen.• Uključite mrežnu sklopku.• Dodirnite .• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.• Povećajte „Brightness“ (Svjetlina), „Contrast“ (Kontrast) ili „Gain“ (Pojačanje) u izborniku Adjustment (Prilagodba). Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.• Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).• Pomaknite miš ili pritisnite neku tipku na tipkovnici.• Provjerite je li računalo uključeno.• Kada je senzor prisutnosti postavljen na „On“ (Uključeno), monitor se može prebaciti u način rada za uštedu energije. Približite se monitoru.• Provjerite je li signalni kabel priključen na  za ulaz DisplayPort signala.  koristi se za izlaz kada se podešava serijsko spajanje.• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.• Povežite putem signalnog kabla prema specifikacijama EIZO. Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.• Kad je spojen na DisplayPort, prebacite verziju DisplayPort-a na 1.1. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).
2. Pojavljuje se poruka ispod. <ul style="list-style-type: none">• Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz čak i ako monitor radi ispravno.• Poruka prikazana lijevo može se pojaviti jer neka računala nemaju izlaz signala odmah nakon uključivanja.• Provjerite je li računalo uključeno.• Provjerite je li signalni kabel ispravno spojen.• Prebacite ulazni signal. Za pojedinosti pogledajte Priručnik za instalaciju (na CD-ROM-u).• Kad je spojen na DisplayPort, prebacite verziju DisplayPort-a na 1.1.• Provjerite je li signalni kabel priključen na  za ulaz DisplayPort signala.  koristi se za izlaz kada se podešava serijsko spajanje.• Isključite mrežno napajanje, a zatim ga ponovo uključite.• Provjerite je li računalo konfiguirirano tako da odgovara razlučivosti i frekvenciji vertikalnog skeniranja monitora (pogledajte „1-5. Kompatibilne razlučivosti“ (stranica 14)).• Ponovo podignite sustav računala.• Odaberite odgovarajuću postavku pomoću uslužnog programa grafičke kartice. Pogledajte priručnik grafičke kartice za pojedinosti.	<p>Ova poruka pojavljuje se kada signal nema ispravan ulaz čak i ako monitor radi ispravno.</p> <p>Primjer:</p>  <p>Poruka pokazuje da je ulazni signal izvan navedenog frekvencijskog raspona. (Takva frekvencija signala prikazuje se u crvenoj boji.) Primjer:</p> 

Poglavlje 5 Specifikacije

5-1. Popis specifikacija

LCD ploča	Vrsta	RX250 IPS (protiv odsjaja) RX250-AR IPS (anti-odraz)
	Pozadinsko osvjetljenje	LED
	Veličina	54,0 cm (21,3 inč)
	Razlučivost	2 M piksela (Portretno usmjerenje: 1200 točaka × 1600 linija (H × V))
	Veličina prikaza (H × V)	324,0 mm × 432,0 mm (usmjerenje portret)
	Gustoća piksela	0,270 mm
	Boje prikaza	10-bitni (DisplayPort): 1073,74 milijuna boja (Maks.) 8-bitni (DVI): 16,77 milijuna boja
	Kutovi prikaza (H / V, tipično)	178° / 178°
	Preporučena svjetlina	400 cd/m ²
	Vrijeme odgovora (tipično)	20 ms (crno -> bijelo -> crno)
Videosignalni	Ulagani terminali	DVI-D (Single Link) × 1, DisplayPort × 1
	Izlazni terminal	DisplayPort × 1
	Frekvencija digitalnog skeniranja (H / V)	31 kHz - 100 kHz / 59 Hz - 61 Hz (VGA TEKST: 69 Hz - 71 Hz) Sinkroni način kadra: 59 Hz - 61 Hz
	Točkasti sat	25,0 MHz - 164,5 MHz
USB	Ulag	Gornji ulaz × 1, Donji ulaz × 2
	Standard	USB Specification Revision 2.0
Napajanje	Ulag	100 - 240 VAC +/-10 %, 50/60 Hz 0,80 A - 0,35 A
	Maksimalna potrošnja energije	79 W ili manje
	Način rada za uštedu energije	1,0 W ili manje (Kada se koristi DVI ulaz, nije spojen USB uređaj, „Auto Input Detection”: „Off”, „Power Save”: „High”, „DDC”: „Off”, „DC5V Output”: „Off”, „DP Power Save”: „On”, „DisplayPort version”: „1.1”, nije spojen vanjski teret)
	Način rada pripravnosti	1,0 W ili manje (Kada nije spojen USB uređaj, „DP Power Save”: „On”, „DC5V Output”: „Off”, „DisplayPort version”: „1.1”, „DDC”: „Off”, nije spojen vanjski teret)
Fizičke specifikacije	Dimenzije	361,0 mm × 510,5 mm - 600,5 mm × 267,0mm (Š × V × D) (Nagib: 30°)
	Dimenzije (bez postolja)	361 mm × 465 mm × 78 mm (Š × V × D)
	Težina	Pribl. 8,2 kg
	Neto Težina (bez postolja)	Pribl. 5,4 kg
	Raspon prilagodbe visine	90 mm (Nagib: 0°)
	Nagib	Gore 30°, dolje 5°
	Zakretanje	70°
	Okretanje	90° (suprotno od kazaljke na satu za portretni prikaz)
Okolni uvjeti rada	Temperatura	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
	Vlažnost	od 20 % do 80 % R.V. (bez kondenzacije)
	Zračni tlak	od 540 hPa do 1060 hPa

Okolni uvjeti prijevoza/ skladištenja	Temperatura	od -20 °C do 60 °C (od 32 °F do 95 °F)
	Vlažnost	od 10 % do 90 % R.V. (bez kondenzacije)
	Zračni tlak	od 200 hPa do 1060 hPa

5-2. Glavne zadane postavke

Način prebacivanja CAL: Prikaz tvornički zadanih postavki je DICOM način rada.

Način rada	Svjetlina	Temperatura	Gamma vrijednost	Hybrid Gamma PXL
1-DICOM	400 cd/m ²	7500 K	DICOM	Off
2-CAL1	400 cd/m ²	7500 K	2.2	Off
3-CAL2	300 cd/m ²	7500 K	DICOM	Off
4-Custom	Približno 300 cd/m ²	7500 K	2.2	- (onemogućeno)
5-sRGB	Približno 250 cd/m ²	sRGB	sRGB	- (onemogućeno)
6-Text	Približno 100 cd/m ²	6500 K	2.2	- (onemogućeno)


Ostalo

Picture Expansion	Dot by Dot
Auto Input Detection	Off
Power Save	High
Indicator	4
Presence Sensor	Off
Languages	English
On-Screen Logo ^{*1}	Off
Image Rotation ^{*1}	Portrait
DDC ^{*1}	Auto
DC5V Output ^{*1}	Off
DP Power Save ^{*1}	Off
Grayscale Warning ^{*1}	On
Sharpness Recovery ^{*1}	On
DisplayPort version ^{*1}	1.2

*1 Ti izbornici ne mogu se pokrenuti s opcijom „Monitor Reset”. (Informacije potražite u Priručniku za instalaciju (na CD-ROM-u)).

5-3. Dimenzije

Jedinica: mm

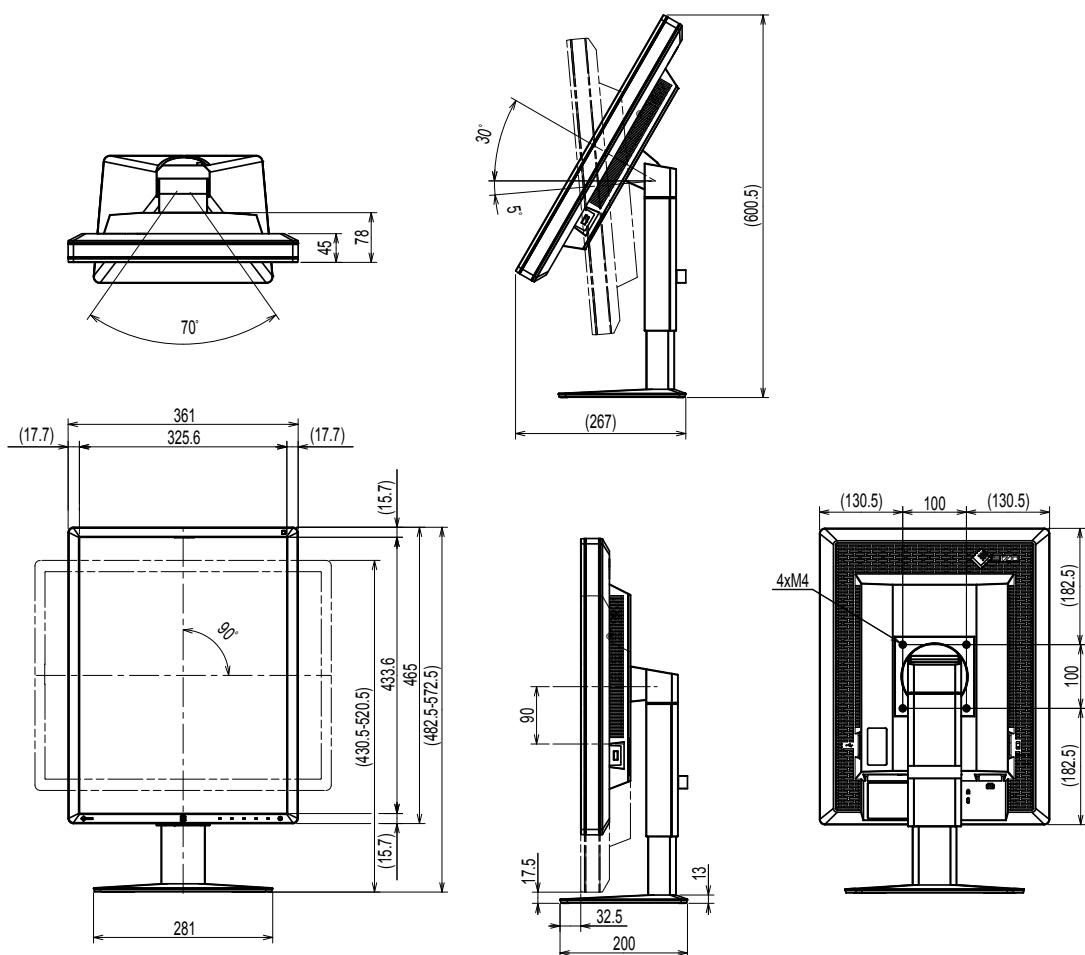

5-4. Dodatna oprema

Komplet za kalibraciju	EIZO „RadiCS UX1“ Ver. 4.4.2 ili novija EIZO „RadiCS Version Up Kit“ Ver. 4.4.2 ili novija
Softver za mrežno QC upravljanje	EIZO „RadiNET Pro“ Ver. 4.4.2 ili novija EIZO „RadiNET Pro Lite“ Ver. 4.4.2 ili novija
Pribor za čišćenje	EIZO „ScreenCleaner“
LCD zaštitni panel	EIZO „RP-915“

Za najnovije informacije o dodatnoj opremi i informacije o najnovijoj kompatibilnoj grafičkoj kartici pogledajte naše web-mjesto.

<http://www.eizoglobal.com>

Poglavlje 6 Pojmovnik

DDC (Display Data Channel) (Kanal za prikazivanje podataka)

VESA omogućuje standardizaciju za interaktivnu komunikaciju informacija o postavkama i sličnom između osobnog računala i monitora.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) (Digitalne slike i komunikacija u medicini)

DICOM standard razvila je krovna američka udruga radiologa American College of Radiology (Američko društvo radiologa) i američko društvo proizvođača električnih uređaja National Electrical Manufacturer's Association (Nacionalna udruga proizvođača električnih uređaja). Uređaj s kompatibilnom vezom za standard DICOM omogućuje prijenos medicinske slike i podataka. DICOM, 14. dio dokumenta definira prikaz digitalne, medicinske slike sivih tonova.

DisplayPort

To je standard sučelja za slikovne signale standardiziran u skladu sa standardom VESA. Razvijen je s ciljem zamjene konvencionalnog DVI i analognih sučelja te može emitirati signale visoke razlučivosti i zvučne signale koje DVI ne podržava. Također podržava 10-bitnu boju, tehnologiju zaštite autorskih prava, duge kabele itd. Priključci standardne i mini veličine standardizirani su.

DVI (Digital Visual Interface) (Digitalno vizualno sučelje)

DVI je standard za digitalno sučelje. DVI omogućuje izravan prijenos digitalnih podataka osobnog računala bez gubitka. Ovo sučelje prihvata sustav prijenosa TMDS i DVI priključke. Postoje dvije vrste DVI priključaka. Jedan je DVI-D priključak samo za ulaz digitalnog signala. Drugi DVI-I priključak za digitalne i analogne ulazne signale.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management) (DVI Upravljanje napajanjem digitalnog monitora)

DVI DMPM je funkcija štednje energije digitalnog sučelja. Radni načini „Monitor ON (rad monitora)” i „Active Off (štednja energije)” neophodni su za DVI DMPM način rada monitora za uštedu energije.

Gama

Općenito svjetlina monitora varira nelinearno s razinom ulaznog signala što se naziva „Gama osobina”. Mala gama vrijednost proizvodi sliku s niskim kontrastom dok velika gama vrijednost proizvodi sliku s visokim kontrastom.

Pojačanje

Ta se značajka upotrebljava za prilagodbu svakog parametra boje za crvenu, zelenu i plavu. LCD monitor prikazuje boju svjetлом koje prolazi kroz filter ploče boja. Crvena, zelena i plava tri su primarne boje. Sve boje na zaslonu prikazane su kombinacijom ovih triju boja. Ton boje može se promijeniti prilagodbom intenziteta svjetla (količine) koji prolazi kroz filter svake boje.

Razlučivost

LCD ploča sastoji se od brojnih piksela određene veličine koji se osvjetljavaju da bi oblikovali slike. Monitor se sastoji od 1536 vodoravnih i 2048 okomitih piksela. Stoga, ako je kombinirana razlučivost lijevog i desnog zaslona 1536×2048 , svi su pikseli osvijetljeni kao puni zaslon (1:1).

Serijsko spajanje

Način spajanja 2 ili više monitora na osobno računalo na serijski način.

sRGB (standard RGB)

Međunarodni standard za reprodukciju boje i prostor boje među perifernim uređajima (kao što su monitori, pisači, digitalni fotoaparati, skeneri). Boje se mogu prikazivati pomoću tonova koji su blizu onima uređaja za prijenos i prijam u obliku jednostavnog slaganja boja za internet.

Temperatura

Temperatura boje način je mjerjenja tona bijele boje koji se obično prikazuje u stupnjevima Kelvina. Zaslon postaje crvenkast pri niskoj temperaturi, a plavkast pri visokoj kao temperatura plamena.

5000 K: Lagano crvenkasto bijelo

6500 K: Bijela kao ujednačena boja dnevnog svjetla

9300 K: Lagano plavkasto bijelo

Dodatak

Zaštitni znak

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing, LLC u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

Logotip DisplayPort Compliance i VESA registrirani su zaštitni znaci tvrtke Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR i Photoshop registrirani su zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

AMD Athlon i AMD Opteron zaštitni su znaci tvrtke Advanced Micro Devices, Inc.

Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook i QuickTime registrirani su zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One i X-Rite registrirani su zaštitni znaci tvrtke X-Rite Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.

ColorVision i ColorVision Spyder2 registrirani su zaštitni znaci tvrtke DataColor Holding AG u Sjedinjenim Državama.

Spyder3 i Spyder4 zaštitni su znaci tvrtke DataColor Holding AG.

ENERGY STAR registrirani je zaštitni znak američke Agencije za zaštitu okoliša u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

GRACoL i IDEAlliance registrirani su zaštitni znaci tvrtke International Digital Enterprise Alliance.

Linux je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldsa.

NEC je registrirani zaštitni znak tvrtke NEC Corporation.

PC-9801 i PC-9821 zaštitni su znaci tvrtke NEC Corporation.

NextWindow je zaštitni znak tvrtke NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core, Pentium i Thunderbolt zaštitni su znaci tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama.

PowerPC je registrirani zaštitni znak tvrtke International Business Machines Corporation.

PlayStation je registrirani zaštitni znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.

PSP i PS3 zaštitni su znaci tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer je registrirani zaštitni znak tvrtke RealNetworks, Inc.

Red Hat je registrirani zaštitni znak tvrtke Red Hat, Inc.

TouchWare je zaštitni znak 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server i Xbox 360 registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

YouTube je registrirani zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Firefox je registrirani zaštitni znak Mozilla Foundation.

Kensington i MicroSaver registrirani su zaštitni znaci tvrtke ACCO Brands Corporation.

EIZO, logotip EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor i ScreenManager registrirani su zaštitni znaci tvrtke EIZO Corporation u Japanu i drugim državama.

ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i•Sound, Screen Administrator i UniColor Pro zaštitni su znaci tvrtke EIZO Corporation.

Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci odgovarajućih vlasnika.

Licenca

Za znakove prikazane na ovom proizvodu upotrijebljen je okrugli gotički podebljani bit map font koji je dizajnirao Ricoh.

Medicinski standard

- Bit će osigurano da konačni sustav bude u skladu sa zahtjevom IEC60601-1-1.
- Električna oprema može emitirati elektromagnetske valove koji mogu utjecati na monitor, ograničavati njegov rad ili rezultirati njegovim kvarom. Ugradite opremu u kontroliranom okruženju u kojem nema takvih efekata.

Klasifikacija opreme

- Vrsta zaštite od strujnog udara : Klasa I
- EMK klasa: EN60601-1-2:2015 Grupa 1 Klasa B
- Klasifikacija medicinskog uređaja (EU) : Klasa I
- Način rada : Neprekidno
- IP Klasa : IPX0

EMK podaci

Serija RadiForce posjeduje performanse koje prikazuju slike na odgovarajući način.

Okruženja za predviđenu namjenu

Serija RadiForce predviđena je za upotrebu u profesionalnim zdravstvenim ustanovama kao što su klinike i bolnice.

Sljedeća okruženja nisu prikladna za seriju RadiForce:

- Kućna zdravstvena okruženja
- U blizini visokofrekventne kirurške opreme kao što su elektrokirurški noževi
- U blizini kratkotalasnih instrumenata za liječenje
- U prostorijama zaštićenim od radiofrekvencije u kojima se nalazi medicinska oprema za MR
- U zaštićenim posebnim okruženjima
- U vozilima, uključujući vozila hitne pomoći.
- Drugim posebnim okruženjima



UPOZORENJE

Serija RadiForce zahtijeva posebne mjere opreza u vezi s EMK i mora biti ugrađena. Morate pažljivo pročitati dijelove „EMK podaci“ i „MJERE OPREZA“ u ovom dokumentu te se pridržavati svih uputa prilikom ugradnje i upotrebe proizvoda.

Serija RadiForce ne smije se upotrebljavati u blizini ili zajedno s drugom opremom. Ako su upotreba u blizini ili zajednička upotreba nužne, oprema ili sustav trebaju se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad u konfiguraciji u kojoj će se upotrijebiti.

Kada se koristi prenosiva RF komunikacijska oprema, održavajte udaljenost od 30 cm (12 inča) ili više od svih dijelova, uključujući kabele, serije RadiForce. U suprotnom može doći do degradacije performansi ove opreme.

Svatko tko spaja dodatnu opremu na signalne ulaze ili signalne izlaze, konfigurira medicinski sustav, odgovoran je da sustav bude u skladu sa zahtjevima IEC/EN60601-1-2.

Obavezno koristite kabele pričvršćene za proizvod ili kabele prema specifikacijama EIZO.

Ako se koriste kabeli koje nije odobrila ili isporučila tvrtka EIZO s ovom opremom, može doći do povećanja elektromagnetske emisije ili smanjenja elektromagnetske otpornosti i nepravilnog rada.

Kabela	Namjenski kabeli tvrtke EIZO	Maks. duljina kabela	Zaštita	Feritna jezgra
Signalni kabel (DisplayPort)	PP300 / PP200	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama
Signalni kabel (DVI-D)	DD300 / FD-C39	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama
USB kabel	UU300 / MD-C93	3 m	Zaštićen	S feritnim jezgrama
Kabel napajanja (s uzemljenjem)	-	3 m	Nezaštićen	Bez feritnih jezgra

Tehničke specifikacije

Elektromagnetske emisije

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju koje je navedeno u nastavku.
Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test emisije	Usklađenost	Elektromagnetsko okruženje – upute
RF emisije CISPR11 / EN55011	Grupa 1	Serija RadiForce upotrebljava RF energiju za svoju internu funkciju. Stoga je njezina RF emisija vrlo niska i vjerojatno neće uzrokovati interferenciju s obližnjom električnom opremom.
RF emisije CISPR11 / EN55011	Klasa B	Serija RadiForce pogodna je za upotrebu u svim prostorima, uključujući kućne prostore i one koji su izravno povezani s javnom niskonaponskom mrežom koja opskrbљuje zgrade koje se upotrebljavaju u stambene svrhe.
Harmoničke emisije IEC / EN61000-3-2	Klasa D	
Kolebanja napona / treperenje IEC / EN61000-3-3	U skladu	

Elektromagnetska otpornost

Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama sukladnosti u skladu sa zahtjevima za testiranje za profesionalne zdravstvene ustanove navedenim u standardu IEC / EN60601-1-2.

Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti	Razina testiranja za profesionalne zdravstvene ustanove	Razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje – upute
Elektrostaticko pražnjenje (ESD) IEC / EN61000-4-2	±8 kV pražnjenje pri kontaktu ±15 kV pražnjenje u zrak	±8 kV pražnjenje pri kontaktu ±15 kV pražnjenje u zrak	Podovi trebaju biti drveni, betonski ili popločani keramikom. Ako su podovi pokriveni sintetičkim materijalom, relativna vlažnost treba biti najmanje 30%.
Brze električne prijelazne pojave / kratki impuls IEC / EN61000-4-4	±2 kV električni vodovi ±1 kV ulazni / izlazni vodovi	±2 kV električni vodovi ±1 kV ulazni / izlazni vodovi	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Udarni prenaponi IEC / EN61000-4-5	±1 kV vod do voda ±2 kV vod do uzemljenja	±1 kV vod do voda ±2 kV vod do uzemljenja	Kvaliteta električne mreže mora biti onakva kakva je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje.
Padovi napona, kratki prekidi i varijacije napona na električnim ulaznim vodovima IEC / EN61000-4-11	0 % U _T (100 % pad u U _T) 0,5 ciklusa i 1 ciklus 70 % U _T (30 % pad u U _T) 25 ciklusa 0 % U _T (100 % pad u U _T) 5 sekundi	0 % U _T (100 % pad u U _T) 0,5 ciklusa i 1 ciklus 70 % U _T (30 % pad u U _T) 25 ciklusa 0 % U _T (100 % pad u U _T) 5 sekundi	Kvaliteta električne mreže mora biti ona koja je tipična za komercijalno ili bolničko okruženje. Ako je korisniku serije RadiForce potreban neprekidan rad tijekom prekida u mreži, preporučuje se da se serija RadiForce napaja iz izvora napajanja ili baterije koji nemaju prekida.
Magnetska polja frekvencije napajanja IEC / EN61000-4-8	30 A/m (50 / 60 Hz)	30 A/m	Magnetska polja frekvencije napajanja trebaju biti na razinama koje su tipične za lokaciju u tipičnom komercijalnom ili bolničkom okruženju. Proizvod se mora držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od izvora magnetskih polja frekvencije napajanja tijekom upotrebe.

Elektromagnetska otpornost

Serija RadiForce testirana je na sljedećim razinama sukladnosti u skladu sa zahtjevima za testiranje za profesionalne zdravstvene ustanove navedenim u standardu IEC / EN60601-1-2.

Klijent ili korisnik serije RadiForce treba osigurati da se upotrebljava u tom okruženju.

Test otpornosti	Razina testiranja za profesionalne zdravstvene ustanove	Razina usklađenosti	Elektromagnetsko okruženje – upute
Vođene smetnje koje uzrokuju RF polja IEC / EN61000-4-6	3 Vrms 150 kHz - 80 MHz 6 Vrms ISM pojasi između 150 kHz i 80 MHz	3 Vrms 6 Vrms	Prenosiva i mobilna RF komunikacijska oprema ne smije se upotrebljavati bliže bilo kojem dijelu serije RadiForce, uključujući kabele, nego što je preporučena udaljenost izračunana jednadžbom primjenjivom na frekvenciju prijenosnika. Preporučena udaljenost $d = 1,2\sqrt{P}$
Zračena RF polja IEC / EN61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	3 V/m	$d = 1,2\sqrt{P}, 80 \text{ MHz} - 800 \text{ MHz}$ $d = 2,3\sqrt{P}, 800 \text{ MHz} - 2,7 \text{ GHz}$ Pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika, a „d“ je preporučena udaljenost u metrima (m). Jačine polja iz fiksnih RF prijenosnika, kako je utvrđeno ispitivanjem elektromagnetskog mesta ^{a)} , trebaju biti manje od razine usklađenosti u svakom frekvencijskom rasponu ^{b)} . Može doći do interferencije u blizini opreme označene sljedećim simbolom. 
Napomena 1 U_T je mrežni izmjenični napon koji prethodi primjeni razine testa.			
Napomena 2 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se veći frekvencijski raspon.			
Napomena 3 Smjernice za vođene smetnje koje uzrokuju RF polja ili zračena RF polja ne moraju biti primjenjive u svim slučajevima. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.			
Napomena 4 ISM pojasi između 150 kHz i 80 MHz iznose od 6,765 MHz do 6,795 MHz, od 13,553 MHz do 13,567 MHz, od 26,957 MHz do 27,283 MHz i od 40,66 MHz do 40,70 MHz.			
a)	Jačine polja iz fiksnih prijenosnika, kao što su osnovne postaje za radio (mobilni/bežični) telefone i zemaljske mobilne radiouredaje, amaterski radio, AM i FM radioemitiranje te TV emitiranje, ne mogu se teoretski predvidjeti s preciznošću. Za procjenu elektromagnetskog okruženja zbog fiksnih RF prijenosnika, treba uzeti u obzir ispitivanje elektromagnetskog mesta. Ako izmjerena jačina polja na lokaciji na kojoj se upotrebljava serija RadiForce premašuje primjenjivu razinu RF usklađenosti iznad, serija RadiForce treba se promatrati kako bi se potvrdio normalan rad. Ako se primijeti neobično ponašanje, mogu biti potrebne dodatne mjere, kao što je preusmjeravanje ili premještanje serije RadiForce.		
b)	Preko frekvencijskog raspona od 150 kHz do 80 MHz, jačine polja moraju biti manje od 3 V/m.		

Preporučene udaljenosti između prenosive ili mobilne RF komunikacijske opreme i serije RadiForce

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje kontrolirane. Klijent ili korisnik serije RadiForce može pomoći u sprječavanju elektromagnetske interferencije održavanjem minimalne udaljenosti između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce. Potvrđena je otpornost na polja u blizini od sljedeće RF bežične komunikacijske opreme:

Mjerna frekvencija (MHz)	Širina pojasa ^{a)} (MHz)	Usluga ^{a)}	Modulacija ^{b)}	Maksimalna snaga (W)	Maksimalna udaljenost (m)	IEC / EN60601 razina testa (V/m)	Razina usklađenosti (V/m)
385	380 - 390	TETRA 400	Modulacija pulsa ^{b)} 18 Hz	1,8	0,3	27	27
450	430 - 470	GMRS 460, FRS 460	FM odstupanje od ±5 kHz sinus od 1 kHz	2	0,3	28	28
710	704 - 787	LTE pojas 13, 17	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
745							
780	800 - 960	GSM 800 / 900, TETRA 800, iDEN 820 CDMA 850, LTE pojas 5	Modulacija pulsa ^{b)} 18 Hz	2	0,3	28	28
810							
870							
930							
1720	1700 - 1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pojas 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
1845							
1970							
2450	2400 - 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE pojas 7	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	2	0,3	28	28
5240	5100 - 5800	WLAN 802.11 a/n	Modulacija pulsa ^{b)} 217 Hz	0,2	0,3	9	9
5500							
5785							

a) Za neke usluge su uključene samo odlazne frekvencije.

b) Valovi nosioci moduliraju se pomoću kvadratnog valnog signala 50% -trog radnog ciklusa.

Serija RadiForce namijenjena je za upotrebu u elektromagnetskom okruženju u kojem su zračene RF smetnje kontrolirane. Za drugu prenosivu i mobilnu RF komunikacijsku opremu (prijenosnike) minimalna udaljenost između prenosive i mobilne RF komunikacijske opreme (prijenosnika) i serije RadiForce kako je preporučeno u nastavku, u skladu s maksimalnom izlaznom snagom komunikacijske opreme.

Nazivna maksimalna izlazna snaga prijenosnika (W)	Udaljenost u skladu s frekvencijom prijenosnika (m)		
	od 150 kHz do 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 80 MHz do 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	od 800 MHz do 2,7 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Za prijenosnike s maksimalnom izlaznom snagom koja nije gore navedena preporučena udaljenost „d“ u metrima (m) može se procijeniti upotrebom jednadžbe primjenjive na frekvenciju prijenosnika, pri čemu je „P“ maksimalna izlazna snaga prijenosnika u vatima (W) u skladu s proizvođačem prijenosnika.

Napomena 1 Pri 80 MHz i 800 MHz primjenjuje se udaljenost za veći frekvencijski raspon.

Napomena 2 Ove smjernice nisu primjenjive u svim situacijama. Elektromagnetsko širenje pod utjecajem je apsorpcije i odraza konstrukcija, predmeta i ljudi.



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

EC REP

EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany



03V25642E1
IFU-RX250